



TONGZHOU КАТАЛОГ

Hangzhou Tongzhou Biotechnology Co., Ltd.

О НАС

Компания HANGZHOU TONGZHOU BIOTECH CO., LTD. является ведущим поставщиком продукции для диагностики *in vitro*. Она осуществляет полный цикл работ: от научно-производственной деятельности и производства до реализации на рынке.

У компании Tongzhou biotech есть специализированный научно-производственный центр, медицинское учреждение, лаборатория, соответствующая стандартам, и оборудование для производства продукции высокого качества. Также в компании внедрена система контроля качества, соответствующая стандарту ISO13485, что позволяет гарантировать качество работы на этапе разработки и производства продукции. Нас ценят за превосходное качество и высокий уровень оказания услуг, начиная с вопросов нормативно-правового регулирования до регулярного взаимодействия с момента заказа до момента доставки.

Наша компания является новатором в области диагностики. Мы выпустили линейку продуктов, предназначенную для проведения экспресс-тестирования непосредственно у постели пациента, включая биологические материалы (антигены и антитела), продукты для исследования женского здоровья и обнаружения инфекционных заболеваний, а также линейку тестов на наркотические препараты, онкомаркеры и кардиомаркеры.

Наша миссия — помочь людям стать более здоровыми. Поэтому мы надеемся выпустить еще больше удобных, эффективных и комплексных решений для применения в области экспресс-тестирования, а также для тестирования у постели пациента. Мы прилагаем все усилия, чтобы усовершенствовать продукцию и услуги по всему миру.



СОДЕРЖАНИЕ

01 Экспресс-тесты
на инфекционные заболевания


10 Экспресс-тесты
для оценки женского здоровья

12 Экспресс-тесты
на наркотические препараты

36 Экспресс-тесты
на онкомаркеры

37 Экспресс-тесты
на кардиомаркеры

38 Другие экспресс-тесты

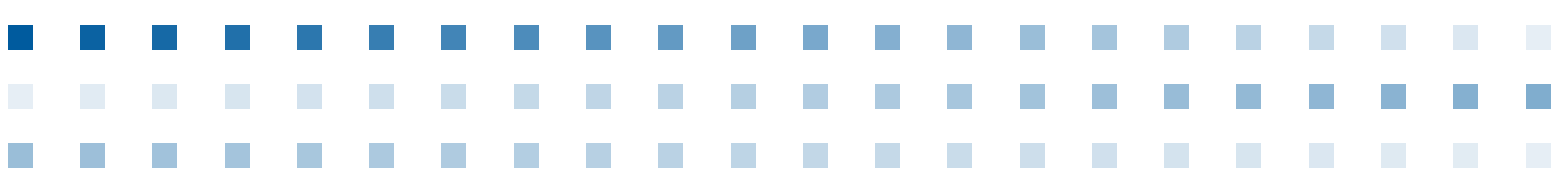

Экспресс-тесты на инфекционные заболевания

Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на стрептококков группы А (с контрольной линией красного цвета)	См. листок-вкладыш	Мазок из носоглотки из зева	Тестовая полоска	I045-5001	25 ТЕСТОВ	CE
Кассета			I045-5002	20 ТЕСТОВ	CE	
Экспресс-тест на стрептококков группы А (с контрольной линией синего цвета)		Мазок из носоглотки из зева	Тестовая полоска	I046-5001	25 ТЕСТОВ	CE
Кассета			I046-5002	20 ТЕСТОВ	CE	
Экспресс-тест на антиген <i>Streptococcus pneumoniae</i>		Моча	Кассета	I047-1002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антиген <i>Mycoplasma pneumoniae</i>		Мазок из носоглотки из зева	Кассета	I048-5002	20 ТЕСТОВ	CE
Комбинированныйэкспресс-тест на антитела IgG/IgM к <i>Mycoplasma Pneumoniae</i>		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I048-4025	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на выявление инфекционного мононуклеоза		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I049-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антиген вида <i>Cryptococcus</i>		Цельная кровь/Сыворотка/плазма /Спинномозговая жидкость (CSF)	Кассета	I080-4002	10/25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антиген H1N1		Мазок из носоглотки	Тестовая полоска	I081-5001	25 ТЕСТОВ	CE
			Кассета	I081-5002	10/20/25 ТЕСТОВ	CE
Комбинированныйэкспресс-тест на вирус гриппа A/B и H1N1		Мазок из носоглотки	Кассета	I084-5025	10/20/25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела IgG к SARS-CoV-2		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I068-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела IgG к домену RBD S-белка SARS-CoV-2		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I069-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на антигены SARS-CoV-2 и вируса гриппа А и В		Мазок из носоглотки Мазок из носоглотки	Кассета	I063-5025	20 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на антигены SARS-CoV-2/вируса гриппа А и В/RSV		Мазок из носоглотки Мазок из носоглотки	Кассета	I064-5035	20 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на антигены SARS-CoV-2/вируса гриппа А и В/RSV/аденовируса		Мазок из носоглотки Мазок из носоглотки	Кассета	I065-5045	25 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на антигены SARS-CoV-2/вируса гриппа А и В/RSV/аденовируса/ <i>M. pneumoniae</i>		Мазок из носоглотки Мазок из носоглотки	Кассета	I070-5055	25 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на антитела IgG к SARS-CoV-2 и <i>M. pneumoniae</i>		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I066-4025	10/20/25 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на антитела IgG/IgM к SARS-CoV-2 и <i>M. pneumoniae</i>		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I067-4025	10/20/25 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

Экспресс-тесты на инфекционные заболевания


Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Тест на антиген SARS-CoV-2	См. листок-вкладыш	Мазок из носоглотки/ Мазок из носоглотки	Кассета	COV-N001	25 ТЕСТОВ	CE
Тест на антиген SARS-CoV-2		Мазок из носоглотки из носа	Кассета	COV-N002	25 ТЕСТОВ	CE
Тест на антиген коронавируса (SARS-CoV-2) для самостоятельного о использования		Мазок из носоглотки из носа	Кассета	COV-NH002	1/2/5/7/10/ 15/20/25T	CE1434
Тест на антиген SARS-CoV-2 (по образцу слюны)		Слюна	Кассета	COV-S001	20 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антиген <i>Adenovirus pneumoniae</i>		Мазок из носоглотки	Кассета	I050-5002	20 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на вирус гриппа А и В		Мазок из носоглотки / Аспират Из Носа	Тестовая полоска	I051-5001	25 ТЕСТОВ	CE
			Кассета	I051-5002	20 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на вирус гриппа А		Мазок из носоглотки / Аспират Из Носа	Тестовая полоска	I052-5001	25 ТЕСТОВ	CE
			Кассета	I052-5002	20 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на RSV		Мазок из носоглотки/ Мзок из носоглотки /Аспират Из Носа	Кассета	I053-5002	20 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на RSV и вирус гриппа А и В		Мзок из носоглотки /Аспират Из Носа	Кассета	I054-5025	10 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на аденовирус и RSV		Мазок из носоглотки/ Мазок из носоглотки	Кассета	I055-5025	10 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на аденовирус, RSV и вирус гриппа А и В		Мазок из носоглотки/ Мазок из носоглотки	Кассета	I056-5035	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на <i>Legionella pneumophila</i>		Моча	Кассета	I073-1002	10/12/ 25/40 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела IgM к <i>Mycoplasma Pneumoniae</i>		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I074-4002	3/4/20/ 30 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела IgG к антигену VCA вируса EBV		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I075-4002	10/25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела IgG к антигену EBNA		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I076-4002	10/25 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на антитела IgG к VCA и EBNA вируса EBV		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I077-4025	10/25 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на <i>S. pneumoniae</i> и <i>L. pneumoohila</i>		Моча	Кассета	I078-1025	10/25 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

Экспресс-тесты на инфекционные заболевания

Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на выявление болезни Шагаса (по образцам сыворотки/плазмы)	См. листок-вкладыш	Сыворотка/плазма	Кассета	I025-3002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на выявление болезни Шагаса (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)		Цельная кровь/Сыворотка /плазма	Кассета	I025-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела IgG/IgM к вирусу Чикунгунья (по образцам сыворотки/плазмы)		Сыворотка/плазма	Кассета	I026-3002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела IgG/IgM к вирусу Чикунгунья (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I026-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела IgG/IgM к вирусу Денге		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I027-4002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антиген NS1 вируса Денге		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I028-4002	10 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на антитела IgG/IgM к вирусу Денге и антиген NS1		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I029-4025	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антиген NS1 вируса Зика		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I030-4002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела IgG/IgM к вирусу Зика		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I031-4002	10 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на антитела IgG/IgM к вирусу Зика и антиген NS1		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I032-4025	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела IgG/IgM к возбудителю филяриатоза(по образцам сыворотки/плазмы)		Сыворотка/плазма	Кассета	I033-3002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела IgG/IgM к возбудителю филяриатоза(по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I034-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела IgG/IgM к возбудителю брюшного тифа (по образцам сыворотки/плазмы)		Сыворотка/плазма	Кассета	I035-3002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела IgG/IgM к возбудителю брюшного тифа(по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Тестовая полоска	I035-4001	50 ТЕСТОВ	CE
			Кассета	I035-4002	25 ТЕСТОВ	CE


*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

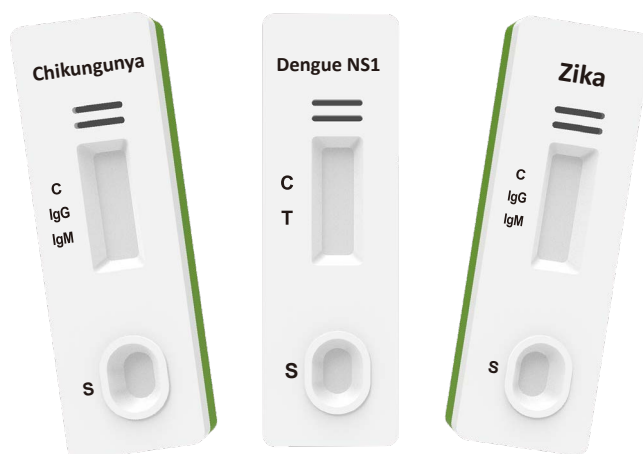

Экспресс-тесты на инфекционные заболевания

Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на антиген <i>Salmonella typhi</i>	См. листок-вкладыш	Кал	Кассета	I036-6002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антиген <i>Salmonella paratyphi</i>		Кал	Кассета	I086-6002	10/20/25 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на антиген <i>Salmonella typhi</i> и <i>Salmonella paratyphi</i>		Кал	Кассета	I088-6025	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела IgG/IgM к <i>Leishmania</i>		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I037-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела IgG/IgM к лептоспирам		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I038-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест для обнаружения возбудителей малярии P.f.		Цельная кровь	Тестовая полоска	I039-4001	50 ТЕСТОВ	CE
			Кассета	I039-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест для обнаружения возбудителей малярии P.f./Pan		Цельная кровь	Кассета	I040-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест для обнаружения возбудителей малярии P.f./P.v.		Цельная кровь	Кассета	I041-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест для обнаружения возбудителей малярии P.f./P.v./Pan		Цельная кровь	Кассета	I042-4002	25 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °С Срок годности: 24 месяца

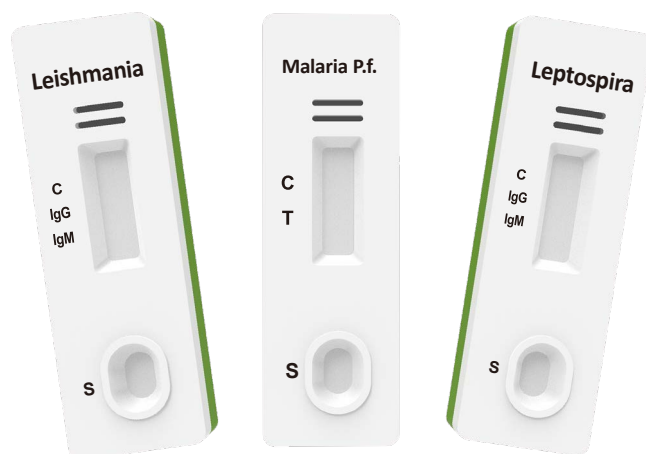

Экспресс-тесты на инфекционные заболевания

Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на аденовирус	См. листок-вкладыш	Кал	Кассета	I005-6002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на ротавирус		Кал	Кассета	I006-6002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на норовирус		Кал	Кассета	I007-6002	10 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на ротавирус и аденовирус		Кал	Кассета	I008-6025	25 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на норовирус, ротавирус и аденовирус		Кал	Кассета	I009-6035	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на астровирус		Кал	Кассета	I010-6002	10 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на норовирус, ротавирус, аденовирус и астровирус		Кал	Кассета	I011-6045	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на <i>Entamoeba histolytica</i>		Кал	Кассета	I012-6002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на <i>Giardia Lamblia</i>		Кал	Кассета	I013-6002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на <i>Cryptosporidium</i>		Кал	Кассета	I014-6002	10 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на <i>Cryptosporidium</i> и <i>Giardia Lamblia</i>		Кал	Кассета	I015-6025	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на <i>Entamoeba/Giardia/Cryptosporidiu</i> (1 окошко)		Кал	Кассета	I016-6002	10 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на <i>Entamoeba/Giardia/Cryptosporidium</i> (3 окошка)		Кал	Кассета	I016-6035	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на <i>Campylobacter</i>		Кал	Кассета	I017-6002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на <i>GDH</i> бактерии <i>Clostridium difficile</i>		Кал	Кассета	I018-6002	10 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на токсин А и В бактерии <i>Clostridium difficile</i>		Кал	Кассета	I019-6025B	10 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на <i>GDH</i> , токсин А и В бактерии <i>Clostridium difficile</i>		Кал	Кассета	I020-6035B	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела к <i>H. pylori</i> (по образцам сыворотки/плазмы)		Сыворотка/плазма	Кассета	I021-3002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела к <i>H. pylori</i> (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Тестовая полоска	I021-4001	50 ТЕСТОВ	CE
			Кассета	I021-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антиген <i>H. pylori</i>	Кал	Тестовая полоска	I021-6001	25 ТЕСТОВ	CE	
		Кассета	I021-6002	25 ТЕСТОВ	CE	

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

Экспресс-тесты на инфекционные заболевания

Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на <i>Vibrio cholerae</i> серогруппы O1 (VC O1)	См. листок-вкладыш	Кал	Кассета	I022-6002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на <i>Vibrio cholerae</i> серогруппы O139 (VC O139)		Кал	Кассета	I023-6002	10 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на <i>Vibrio cholerae</i> серогруппы O1/O139		Кал	Кассета	I024-6025	10 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

Желудочно-кишечные заболевания

Название продукта


Экспресс-тест на HBsAg	См. листок-вкладыш	Сыворотка/плазма	Тестовая полоска	I091-3001	50 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на HBsAg		Сыворотка/плазма	Кассета	I091-3002	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на HBsAg		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Тестовая полоска	I091-4001	50 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на HBsAg		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I091-4002	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на HBsAb		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Тестовая полоска	I092-4001	50 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на HBsAb		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I092-4002	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на HBsAb		Сыворотка/плазма	Тестовая полоска	I092-3001	50 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на HBsAb		Сыворотка/плазма	Кассета	I092-3002	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на HBcAb		Сыворотка/плазма	Кассета	I093-3002	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на HBeAb		Сыворотка/плазма	Кассета	I094-3002	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на HBeAg		Сыворотка/плазма	Кассета	I095-3002	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Комбинированный экспресс-тест на вирус гепатита В		Сыворотка/плазма	Кассета	I096-3055	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на вирус гепатит С		Сыворотка/плазма	Тестовая полоска	I097-3001	50 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на вирус гепатита С		Сыворотка/плазма	Кассета	I097-3002	25 ТЕСТОВ	NON-CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

Экспресс-тесты на инфекционные заболевания

Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на вирус гепатит С	См. листок-вкладыш	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Тестовая полоска	I097-4001	50 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на вирус гепатит С		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I097-4002	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на антитела IgG/IgM к вирусу гепатита E		Сыворотка/плазма	Кассета	I043-3002	40 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на ВИЧ-1/2		Сыворотка/плазма	Кассета	I099-3002	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на ВИЧ-1/2		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Тестовая полоска	I099-4001	50 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на ВИЧ-1/2		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I099-4002	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Набор одноразового использования для экспресс-теста на ВИЧ-1/2		Цельная кровь	Кассета	I099-4002S	1 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на ВИЧ-1/2 и подтип O		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Тестовая полоска	I100-4001	50 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на ВИЧ-1/2 и подтип O		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I100-4002	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Набор одноразового использования для экспресс-теста на ВИЧ-1/2 и подтип O		Цельная кровь	Кассета	I100-4002S	1 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на антиген p24 ВИЧ		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I101-4002	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Комбинированный экспресс-тест на ВИЧ-1/2 и антиген p24 ВИЧ		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I102-4025	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Комбинированный экспресс-тест на ВИЧ-1/2 и антиген p24 ВИЧ		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I102-4002	25 ТЕСТОВ	NON-CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

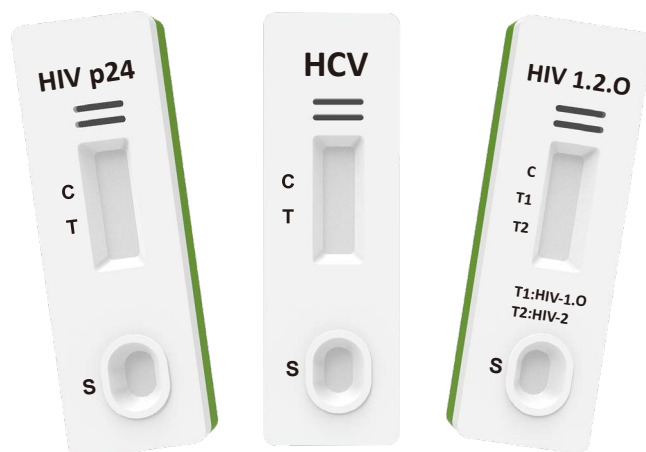

Экспресс-тесты на инфекционные заболевания


Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на выявление сифилиса (по образцам сыворотки/плазмы)	См. листок-вкладыш	Сыворотка/плазма	Тестовая полоска	I044-3001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на выявление сифилиса (по образцам сыворотки/плазмы)		Сыворотка/плазма	Кассета	I044-3002	20/25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на выявление сифилиса		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Тестовая полоска	I044-4001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на выявление сифилиса		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I044-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на HBsAg и вирус гепатита С		Сыворотка/плазма	Кассета	I103-3025	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Комбинированный экспресс-тест на HBsAg и вирус гепатита С		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I103-4025	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Комбинированный экспресс-тест на выявление сифилиса/ВИЧ-1/2		Сыворотка/плазма	Кассета	I104-3025	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Комбинированный экспресс-тест на выявление сифилиса/ВИЧ-1/2 и подтип О		Сыворотка/плазма	Кассета	I105-3025	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Комбинированный экспресс-тест на выявление сифилиса/ВИЧ-1/2 и подтип О		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I105-4025	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Комбинированный экспресс-тест на выявление ВИЧ-1/2 и сифилиса (на одной тест-полоске)		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I106-4002	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Комбинированный экспресс-тест на HBsAg/вирус гепатита С/ВИЧ		Сыворотка/плазма	Кассета	I107-3035	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Комбинированный экспресс-тест на выявление HBsAg/вируса гепатита С/ВИЧ/сифилиса		Сыворотка/плазма	Кассета	I108-3045	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Комбинированный экспресс-тест на выявление HBsAg/вируса гепатита С/ВИЧ/сифилиса		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I108-4045	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на антитела IgM к вирусу гепатита А		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I082-4002	10/20/25 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на антитела IgG/IgM к вирусу гепатита А		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I083-4025	10/20/25 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °С Срок годности: 24 месяца

Экспресс-тесты на инфекционные заболевания

Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на антиген Brucella Abortus	См. листок-вкладыш	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I057-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела IgG/IgM к возбудителю болезни Лайма		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I058-4002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на выявление столбняка		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I059-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на выявление туберкулеза		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Тестовая полоска	I060-4001	50 ТЕСТОВ	CE
			Кассета	I060-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела IgG/IgM к возбудителю лихорадки цуцугамуши		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I079-4002	10/25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела к вирусу оспы обезьян		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I089-4002	10/20/ 25/40 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антигены вируса оспы обезьян		Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	I090-4002	10/20/ 25/40 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

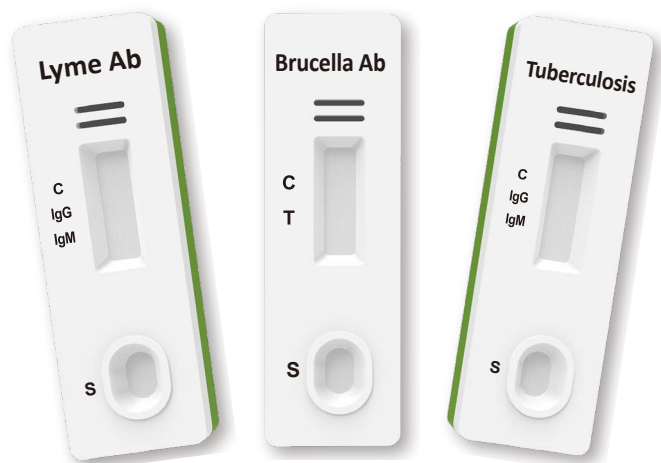

Экспресс-тесты для оценки женского здоровья

Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на беременность (ХГЧ)	20 mME/мл, 25 mME/мл*	Моча	Тестовая полоска	F001-1001	50 ТЕСТОВ	CE
			Кассета	F001-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	F001-1011	25 ТЕСТОВ	CE
	10 mME/мл	Моча	Тестовая полоска	F001-U1001	50 ТЕСТОВ	CE
			Кассета	F001-U1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	F001-U1011	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на беременность (ХГЧ) (по образцу мочи)	40 mME/мл	Моча	Тестовая полоска	F001-A1001	50 ТЕСТОВ	CE
			Кассета	F001-A1002	25 ТЕСТОВ	CE
	200 mME/мл	Моча	Тестовая полоска	F001-B1001	50 ТЕСТОВ	CE
			Кассета	F001-B1002	25 ТЕСТОВ	CE
	500 mME/мл	Моча	Тестовая полоска	F001-C1001	50 ТЕСТОВ	CE
			Кассета	F001-C1002	25 ТЕСТОВ	CE
	2000 mME/мл	Моча	Тестовая полоска	F001-D1001	50 ТЕСТОВ	CE
			Кассета	F001-D1002	25 ТЕСТОВ	CE
Тест-полоска для экспресс-теста на беременность (ХГЧ) по средней порции мочи	25 mME/мл	Моча	Тест-полоска для анализа по средней порции мочи	F001-1003	1 ТЕСТОВ	CE
	10 mME/мл	Моча	Тест-полоска для анализа по средней порции мочи	F001-U1003	1 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на беременность (ХГЧ) (по образцам сыворотки/плазмы/мочи)	20 mME/мл, 25 mME/мл*	Сыворотка/плазма/Моча	Тестовая полоска	F001-2001	50 ТЕСТОВ	CE
			Кассета	F001-2002	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	F001-2011	25 ТЕСТОВ	CE
	10 mME/мл	Сыворотка/плазма/Моча	Тестовая полоска	F001-U2001	50 ТЕСТОВ	CE
			Кассета	F001-U2002	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	F001-U2011	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на беременность (ХГЧ)(по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	25 mME/мл	Цельная кровь/Сыворотка/плазма	Кассета	F001-4002	25 ТЕСТОВ	CE
	10 mME/мл		Кассета	F001-U4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на овуляцию (ЛГ)	35 mME/мл, 40 mME/мл*	Моча	Тестовая полоска	F002-1001	50 ТЕСТОВ	CE
			Кассета	F002-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	F002-1011	25 ТЕСТОВ	CE
	30 mME/мл	Моча	Тестовая полоска	F002-U1001	50 ТЕСТОВ	CE
			Кассета	F002-U1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	F002-U1011	25 ТЕСТОВ	CE
Тест-полоска для экспресс-теста на овуляцию (ЛГ) по средней порции мочи	40 mME/мл	Моча	Тест-полоска для анализа по средней порции мочи	F002-1003	1 ТЕСТОВ	CE
	35 mME/мл		Тест-полоска для анализа по средней порции мочи	F002-M1003	1 ТЕСТОВ	CE
	30 mME/мл		Тест-полоска для анализа по средней порции мочи	F002-U1003	1 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на ФСГ	25 mME/мл	Моча	Тестовая полоска	F003-1001	50 ТЕСТОВ	CE
			Кассета	F003-1002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на АМГ	1-7 нг/мл	Цельная кровь/Сыворотка/плазма	Кассета	F004-4002	10 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2-30 °C Срок годности: 24 месяца

Экспресс-тесты для оценки женского здоровья

Название продукта	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на фетальный фибронектин (fFN)	Влагалищные выделения	Кассета	F005-5002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на белок-1, связывающий инсулиноподобный фактор роста (IGFBP-1)	Влагалищные выделения	Кассета	F006-5002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела IgM к ВПГ-1/2 (по образцам сыворотки/плазмы)	Сыворотка/плазма	Кассета	I061-3002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела IgM к ВПГ-1/2 (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	Цельная кровь/Сыворотка/плазма	Кассета	I061-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела IgG к ВПГ-1/2 (по образцам сыворотки/плазмы)	Сыворотка/плазма	Кассета	I071-3002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела IgG к ВПГ-1/2 (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	Цельная кровь/Сыворотка/плазма	Кассета	I071-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела IgG/IgM к ВПГ-1/2 (по образцам сыворотки/плазмы)	Сыворотка/плазма	Кассета	I062-3002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на антитела IgG/IgM к ВПГ-1/2 (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	Цельная кровь/Сыворотка/плазма	Кассета	I062-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на антитела IgG/IgM к ВПГ-1/2	Цельная кровь/Сыворотка/плазма	Кассета	I062-4025	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на <i>Candida albicans</i>	Мазок из носо- и влагалища	Кассета	I001-5002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на выявление гонореи	Мазок из носо- и влагалища	Кассета	I002-5002	20 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на выявление гонореи и хламидиоза	Мазок из носо- и влагалища	Кассета	I003-5025	10 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на стрептококков группы В	Мазок из носо- и влагалища	Тестовая полоска	I004-5001	25 ТЕСТОВ	CE
	Мазок из носо- и влагалища	Кассета	I004-5002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на <i>Trichomonas Vaginalis</i>	Мазок из носо- и влагалища	Кассета	I085-5002	10/20/25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на выявление хламидиоза	Мазок из носо- и влагалища/Моча	Кассета	I098-5002	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на антитела IgM к ЦМВ	Цельная кровь/Сыворотка/плазма	Кассета	I111-4002	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на антитела IgG к ЦМВ	Цельная кровь/Сыворотка/плазма	Кассета	I112-4002	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на антитела IgG/IgM к ЦМВ	Цельная кровь/Сыворотка/плазма	Кассета	I113-4002	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на антитела IgG/IgM к токсоплазмам	Цельная кровь/Сыворотка/плазма	Кассета	I114-4002	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на антитела IgG к токсоплазмам	Цельная кровь/Сыворотка/плазма	Кассета	I115-4002	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на антитела IgM к токсоплазмам	Цельная кровь/Сыворотка/плазма	Кассета	I116-4002	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Комбинированный экспресс-тест на антитела IgG/IgM к токсоплазмам	Цельная кровь/Сыворотка/плазма	Кассета	I114-4025	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Комбинированный экспресс-тест на антитела IgG/IgM к возбудителям ToRCH-инфекций	Цельная кровь/Сыворотка/плазма	Кассета	I117-4045	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на антитела IgM к вирусу краснухи	Цельная кровь/Сыворотка/плазма	Кассета	I109-4002	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на антитела IgG/IgM к вирусу краснухи	Цельная кровь/Сыворотка/плазма	Кассета	I110-4002	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Комбинированный экспресс-тест на антитела IgG/IgM к вирусу краснухи	Сыворотка/плазма	Кассета	I110-3025	25 ТЕСТОВ	NON-CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

Экспресс-тесты на наркотические препараты


Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на 7-амино-клоназепам (7-ACL)	300 нг/мл*	Моча	Кассета	D001-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D001-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D001-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на амфетамин (AMP)	300 нг/мл, 500 нг/мл, 1000 нг/мл*	Моча	Кассета	D002-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D002-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D002-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на барбитурат (BAR)	200 нг/мл, 300 нг/мл*	Моча	Кассета	D003-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D003-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D003-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на бупренорфин (BUP)	5 нг/мл, 10 нг/мл*	Моча	Кассета	D004-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D004-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D004-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на бензодиазепины (BZO)	100 нг/мл, 200 нг/мл, 300 нг/мл*	Моча	Кассета	D005-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D005-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D005-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на кокаин (COC)	100 нг/мл, 150 нг/мл, 300 нг/мл*	Моча	Кассета	D006-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D006-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D006-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на котинин (COT)	10 нг/мл, 50 нг/мл, 100 нг/мл, 200 нг/мл*, 500 нг/мл	Моча	Кассета	D007-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D007-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D007-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на этилендиамин-диметилфосфиновую кислоту (EDDP)	100 нг/мл, 300 нг/мл*	Моча	Кассета	D008-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D008-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D008-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на этилглюкуронид (ETG)	500 нг/мл*, 1000 нг/мл	Моча	Кассета	D009-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D009-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D009-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на фентанил (FYL)	10 нг/мл , 20 нг/мл* , 100 нг/мл , 200 ng/m	Моча	Кассета	D010-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D010-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D010-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на кетамин (KET)	100 нг/мл, 300 нг/мл, 500 нг/мл, 1000 нг/мл*	Моча	Кассета	D011-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D011-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D011-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на экстази (MDMA)	500 нг/мл*, 1000 нг/мл	Моча	Кассета	D012-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D012-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D012-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на метамфетамин (MET)	300 нг/мл, 500 нг/мл, 1000 нг/мл*	Моча	Кассета	D013-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D013-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D013-1001	50 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

Экспресс-тесты на наркотические препараты

Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на морфин (MOP)	100 нг/мл, 300 нг/мл*	Моча	Кассета	D014-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D014-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D014-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на метилфенидат (MPD)	300 нг/мл 1000 нг/мл*	Моча	Кассета	D015-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D015-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D015-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на метадон (MTD)	200 нг/мл, 300 нг/мл* 300 нг/мл*	Моча	Кассета	D016-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D016-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D016-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на опиаты (OPI)	300 нг/мл, 2000 нг/мл*	Моча	Кассета	D017-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D017-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D017-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на оксикодон (OXY)	100 нг/мл*	Моча	Кассета	D018-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D018-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D018-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на фенциклидин (PCP)	25 нг/мл*	Моча	Кассета	D019-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D019-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D019-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на синтетические каннабиноиды (K2)	25 нг/мл, 30 нг/мл, 50 нг/мл*	Моча	Кассета	D020-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D020-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D020-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на трициклические антидепрессанты (ТЦА)	300 нг/мл, 500 нг/мл, 1000 нг/мл*	Моча	Кассета	D021-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D021-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D021-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на марихуану (THC)	20 нг/мл, 25 нг/мл, 50 нг/мл*, 150 нг/мл, 300 нг/мл, 600 нг/мл	Моча	Кассета	D022-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D022-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D022-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на золпидем (ZOL)	50 нг/мл*	Моча	Кассета	D023-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D023-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D023-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на зопиклон (ZOP)	50 нг/мл*	Моча	Кассета	D024-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D024-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D024-1001	50 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

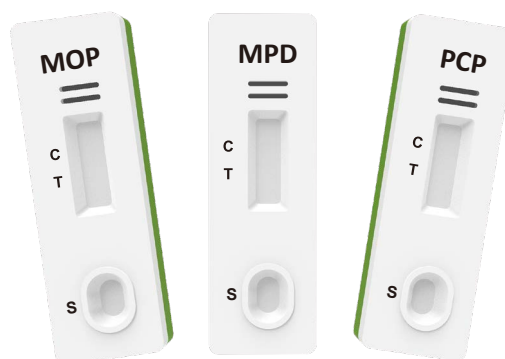

Экспресс-тесты на наркотические препараты

Название продукта	Формат образца	Препараты	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тесты на наркотические препараты	Моча	2 параметры	Кассета	D000-1025	25 ТЕСТОВ	CE
		2 параметры	Панель	D000-1024	25 ТЕСТОВ	CE
		3 параметры	Кассета	D000-1035	25 ТЕСТОВ	CE
		3 параметры	Панель	D000-1034	25 ТЕСТОВ	CE
		4 параметры	Кассета	D000-1045	25 ТЕСТОВ	CE
		4 параметры	Панель	D000-1044	25 ТЕСТОВ	CE
		5 параметров	Кассета	D000-1055	25 ТЕСТОВ	CE
		5 параметров	Панель	D000-1054	25 ТЕСТОВ	CE
		6 параметров	Кассета	D000-1065	25 ТЕСТОВ	CE
		6 параметров	Панель	D000-1064	25 ТЕСТОВ	CE
		7 параметров	Кассета	D000-1075	25 ТЕСТОВ	CE
		7 параметров	Панель	D000-1074	25 ТЕСТОВ	CE
		8 параметров	Кассета	D000-1085	25 ТЕСТОВ	CE
		8 параметров	Панель	D000-1084	25 ТЕСТОВ	CE
		9 параметров	Кассета	D000-1095	25 ТЕСТОВ	CE
		9 параметров	Панель	D000-1094	25 ТЕСТОВ	CE
		10 параметров	Кассета	D000-1105	25 ТЕСТОВ	CE
		10 параметров	Панель	D000-1104	25 ТЕСТОВ	CE
		11 параметров	Кассета	D000-1115	25 ТЕСТОВ	CE
		11 параметров	Панель	D000-1114	25 ТЕСТОВ	CE
		12 параметров	Кассета	D000-1125	25 ТЕСТОВ	CE
		12 параметров	Панель	D000-1124	25 ТЕСТОВ	CE
		13 параметров	Кассета	D000-1135	25 ТЕСТОВ	CE
		13 параметров	Панель	D000-1134	25 ТЕСТОВ	CE
		14 параметров	Кассета	D000-1145	25 ТЕСТОВ	CE
		14 параметров	Панель	D000-1144	25 ТЕСТОВ	CE
		15 параметров	Кассета	D000-1155	25 ТЕСТОВ	CE
		15 параметров	Панель	D000-1154	25 ТЕСТОВ	CE
		16 параметров	Кассета	D000-1165	25 ТЕСТОВ	CE
		16 параметров	Панель	D000-1164	25 ТЕСТОВ	CE
		17 параметров	Кассета	D000-1175	25 ТЕСТОВ	CE
		17 параметров	Панель	D000-1174	25 ТЕСТОВ	CE
		18 параметров	Панель	D000-1184	25 ТЕСТОВ	CE
		19 параметров	Панель	D000-1194	25 ТЕСТОВ	CE
		20 параметров	Панель	D000-1204	25 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

Экспресс-тесты на наркотические препараты

Название продукта	Формат образца	Препараты	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на наркотические препараты (примечание: с обнаружением примесей)	Моча	2 параметры	Кассета	DU00-1025	25 ТЕСТОВ	CE
		2 параметры	Панель	DU00-1024	25 ТЕСТОВ	CE
		3 параметры	Кассета	DU00-1035	25 ТЕСТОВ	CE
		3 параметры	Панель	DU00-1034	25 ТЕСТОВ	CE
		4 параметры	Кассета	DU00-1045	25 ТЕСТОВ	CE
		4 параметры	Панель	DU00-1044	25 ТЕСТОВ	CE
		5 параметров	Кассета	DU00-1055	25 ТЕСТОВ	CE
		5 параметров	Панель	DU00-1054	25 ТЕСТОВ	CE
		6 параметров	Кассета	DU00-1065	25 ТЕСТОВ	CE
		6 параметров	Панель	DU00-1064	25 ТЕСТОВ	CE
		7 параметров	Кассета	DU00-1075	25 ТЕСТОВ	CE
		7 параметров	Панель	DU00-1074	25 ТЕСТОВ	CE
		8 параметров	Кассета	DU00-1085	25 ТЕСТОВ	CE
		8 параметров	Панель	DU00-1084	25 ТЕСТОВ	CE
		9 параметров	Кассета	DU00-1095	25 ТЕСТОВ	CE
		9 параметров	Панель	DU00-1094	25 ТЕСТОВ	CE
		10 параметров	Кассета	DU00-1105	25 ТЕСТОВ	CE
		10 параметров	Панель	DU00-1104	25 ТЕСТОВ	CE
		11 параметров	Кассета	DU00-1115	25 ТЕСТОВ	CE
		11 параметров	Панель	DU00-1114	25 ТЕСТОВ	CE
		12 параметров	Кассета	DU00-1125	25 ТЕСТОВ	CE
		12 параметров	Панель	DU00-1124	25 ТЕСТОВ	CE
		13 параметров	Кассета	DU00-1135	25 ТЕСТОВ	CE
		13 параметров	Панель	DU00-1134	25 ТЕСТОВ	CE
		14 параметров	Кассета	DU00-1145	25 ТЕСТОВ	CE
		14 параметров	Панель	DU00-1144	25 ТЕСТОВ	CE
		15 параметров	Кассета	DU00-1155	25 ТЕСТОВ	CE
		15 параметров	Панель	DU00-1154	25 ТЕСТОВ	CE
		16 параметров	Кассета	DU00-1165	25 ТЕСТОВ	CE
		16 параметров	Панель	DU00-1164	25 ТЕСТОВ	CE
		17 параметров	Кассета	DU00-1175	25 ТЕСТОВ	CE
		17 параметров	Панель	DU00-1174	25 ТЕСТОВ	CE
		18 параметров	Панель	DU00-1184	25 ТЕСТОВ	CE
		19 параметров	Панель	DU00-1194	25 ТЕСТОВ	CE
		20 параметров	Панель	DU00-1204	25 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

Экспресс-тесты на наркотические препараты

Название продукта	Формат образца	Препараты	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Контейнер для одноэтапного экспресс-теста на наркотические препараты	Моча	2 параметры	Контейнер	D000-1027-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		3 параметры	Контейнер	D000-1037-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		4 параметры	Контейнер	D000-1047-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		5 параметры	Контейнер	D000-1057-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		6 параметры	Контейнер	D000-1067-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		7 параметры	Контейнер	D000-1077-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		8 параметры	Контейнер	D000-1087-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		9 параметры	Контейнер	D000-1097-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		10 параметры	Контейнер	D000-1107-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		11 параметры	Контейнер	D000-1117-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		12 параметры	Контейнер	D000-1127-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		13 параметры	Контейнер	D000-1137-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		14 параметры	Контейнер	D000-1147-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		15 параметров	Контейнер	D000-1157-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		2 параметры	Контейнер	D000-1027-A2	25 ТЕСТОВ	CE
		3 параметры	Контейнер	D000-1037-A2	25 ТЕСТОВ	CE
		4 параметры	Контейнер	D000-1047-A2	25 ТЕСТОВ	CE
		5 параметров	Контейнер	D000-1057-A2	25 ТЕСТОВ	CE
		6 параметров	Контейнер	D000-1067-A2	25 ТЕСТОВ	CE
		7 параметров	Контейнер	D000-1077-A2	25 ТЕСТОВ	CE
		8 параметров	Контейнер	D000-1087-A2	25 ТЕСТОВ	CE
		9 параметров	Контейнер	D000-1097-A2	25 ТЕСТОВ	CE
		10 параметров	Контейнер	D000-1107-A2	25 ТЕСТОВ	CE
		11 параметров	Контейнер	D000-1117-A2	25 ТЕСТОВ	CE
		12 параметров	Контейнер	D000-1127-A2	25 ТЕСТОВ	CE
		2 параметры	Контейнер	D000-1027-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		3 параметров	Контейнер	D000-1037-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		4 параметров	Контейнер	D000-1047-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		5 параметров	Контейнер	D000-1057-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		6 параметров	Контейнер	D000-1067-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		7 параметров	Контейнер	D000-1077-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		8 параметров	Контейнер	D000-1087-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		9 параметров	Контейнер	D000-1097-A3	25 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

Экспресс-тесты на наркотические препараты

Название продукта	Формат образца	Препараты	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Контейнер для одноэтапного экспресс-теста на наркотические препараты	Моча	10 параметры	Контейнер	D000-1107-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		11 параметры	Контейнер	D000-1117-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		12 параметры	Контейнер	D000-1127-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		13 параметры	Контейнер	D000-1137-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		14 параметры	Контейнер	D000-1147-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		15 параметры	Контейнер	D000-1157-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		16 параметры	Контейнер	D000-1167-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		17 параметры	Контейнер	D000-1177-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		18 параметры	Контейнер	D000-1187-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		19 параметры	Контейнер	D000-1197-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		20 параметры	Контейнер	D000-1207-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		21 параметры	Контейнер	D000-1217-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		22 параметры	Контейнер	D000-1227-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		2 параметры	Контейнер	D000-1027-A10	25 ТЕСТОВ	CE
		3 параметры	Контейнер	D000-1037-A10	25 ТЕСТОВ	CE
		4 параметры	Контейнер	D000-1047-A10	25 ТЕСТОВ	CE
		5 параметры	Контейнер	D000-1057-A10	25 ТЕСТОВ	CE
		6 параметры	Контейнер	D000-1067-A10	25 ТЕСТОВ	CE
		7 параметры	Контейнер	D000-1077-A10	25 ТЕСТОВ	CE
		8 параметры	Контейнер	D000-1087-A10	25 ТЕСТОВ	CE
		9 параметры	Контейнер	D000-1097-A10	25 ТЕСТОВ	CE
		10 параметры	Контейнер	D000-1107-A10	25 ТЕСТОВ	CE
		11 параметры	Контейнер	D000-1117-A10	25 ТЕСТОВ	CE
		12 параметры	Контейнер	D000-1127-A10	25 ТЕСТОВ	CE
		13 параметры	Контейнер	D000-1137-A10	25 ТЕСТОВ	CE
		14 параметры	Контейнер	D000-1147-A10	25 ТЕСТОВ	CE
		15 параметры	Контейнер	D000-1157-A10	25 ТЕСТОВ	CE
		16 параметров	Контейнер	D000-1167-A10	25 ТЕСТОВ	CE
		17 параметров	Контейнер	D000-1177-A10	25 ТЕСТОВ	CE
		18 параметров	Контейнер	D000-1187-A10	25 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца



Экспресс-тесты на наркотические препараты

Название продукта	Формат образца	Препараты	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Контейнер для одноэтапного экспресс-теста на наркотические препараты (примечание: с обнаружением примесей)	Моча	2 параметры	Контейнер	DU00-1027-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		3 параметры	Контейнер	DU00-1037-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		4 параметры	Контейнер	DU00-1047-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		5 параметров	Контейнер	DU00-1057-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		6 параметров	Контейнер	DU00-1067-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		7 параметров	Контейнер	DU00-1077-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		8 параметров	Контейнер	DU00-1087-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		9 параметров	Контейнер	DU00-1097-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		10 параметров	Контейнер	DU00-1107-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		11 параметров	Контейнер	DU00-1117-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		12 параметров	Контейнер	DU00-1127-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		13 параметров	Контейнер	DU00-1137-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		14 параметров	Контейнер	DU00-1147-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		15 параметров	Контейнер	DU00-1157-A1	25 ТЕСТОВ	CE
		2 параметры	Контейнер	DU00-1027-A2	25 ТЕСТОВ	CE
		2 параметры	Контейнер	DU00-1037-A2	25 ТЕСТОВ	CE
		4 параметры	Контейнер	DU00-1047-A2	25 ТЕСТОВ	CE
		5 параметров	Контейнер	DU00-1057-A2	25 ТЕСТОВ	CE
		6 параметров	Контейнер	DU00-1067-A2	25 ТЕСТОВ	CE
		7 параметров	Контейнер	DU00-1077-A2	25 ТЕСТОВ	CE
		8 параметров	Контейнер	DU00-1087-A2	25 ТЕСТОВ	CE
		9 параметров	Контейнер	DU00-1097-A2	25 ТЕСТОВ	CE
		10 параметров	Контейнер	DU00-1107-A2	25 ТЕСТОВ	CE
		11 параметров	Контейнер	DU00-1117-A2	25 ТЕСТОВ	CE
		12 параметров	Контейнер	DU00-1127-A2	25 ТЕСТОВ	CE
		2 параметры	Контейнер	DU00-1027-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		3 параметры	Контейнер	DU00-1037-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		4 параметры	Контейнер	DU00-1047-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		5 параметров	Контейнер	DU00-1057-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		6 параметров	Контейнер	DU00-1067-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		7 параметров	Контейнер	DU00-1077-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		8 параметров	Контейнер	DU00-1087-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		9 параметров	Контейнер	DU00-1097-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		10 параметров	Контейнер	DU00-1107-A3	25 ТЕСТОВ	CE
		11 параметров	Контейнер	DU00-1117-A3	25 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

Экспресс-тесты на наркотические препараты

Название продукта	Формат образца	Препараты	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE	
Контейнер для одноэтапного экспресс-теста на наркотические препараты (примечание: с обнаружением примесей)	Моча	12 параметры	Контейнер	DU00-1127-A3	25 ТЕСТОВ	CE	
		13 параметры	Контейнер	DU00-1137-A3	25 ТЕСТОВ	CE	
		14 параметры	Контейнер	DU00-1147-A3	25 ТЕСТОВ	CE	
		15 параметры	Контейнер	DU00-1157-A3	25 ТЕСТОВ	CE	
		16 параметры	Контейнер	DU00-1167-A3	25 ТЕСТОВ	CE	
		17 параметры	Контейнер	DU00-1177-A3	25 ТЕСТОВ	CE	
		18 параметры	Контейнер	DU00-1187-A3	25 ТЕСТОВ	CE	
		19 параметры	Контейнер	DU00-1197-A3	25 ТЕСТОВ	CE	
		20 параметры	Контейнер	DU00-1207-A3	25 ТЕСТОВ	CE	
		21 параметры	Контейнер	DU00-1217-A3	25 ТЕСТОВ	CE	
		22 параметры	Контейнер	DU00-1227-A3	25 ТЕСТОВ	CE	
		2 параметры	Контейнер	DU00-1027-A10	25 ТЕСТОВ	CE	
		3 параметры	Контейнер	DU00-1037-A10	25 ТЕСТОВ	CE	
		4 параметры	Контейнер	DU00-1047-A10	25 ТЕСТОВ	CE	
		5 параметры	Контейнер	DU00-1057-A10	25 ТЕСТОВ	CE	
		6 параметры	Контейнер	DU00-1067-A10	25 ТЕСТОВ	CE	
		7 параметры	Контейнер	DU00-1077-A10	25 ТЕСТОВ	CE	
		8 параметры	Контейнер	DU00-1087-A10	25 ТЕСТОВ	CE	
		9 параметры	Контейнер	DU00-1097-A10	25 ТЕСТОВ	CE	
		10 параметры	Контейнер	DU00-1107-A10	25 ТЕСТОВ	CE	
		11 параметры	Контейнер	DU00-1117-A10	25 ТЕСТОВ	CE	
		12 параметры	Контейнер	DU00-1127-A10	25 ТЕСТОВ	CE	
		13 параметры	Контейнер	DU00-1137-A10	25 ТЕСТОВ	CE	
		14 параметры	Контейнер	DU00-1147-A10	25 ТЕСТОВ	CE	
		15 параметры	Контейнер	DU00-1157-A10	25 ТЕСТОВ	CE	
		16 параметры	Контейнер	DU00-1167-A10	25 ТЕСТОВ	CE	
		17 параметры	Контейнер	DU00-1177-A10	25 ТЕСТОВ	CE	
		18 параметры	Контейнер	DU00-1187-A10	25 ТЕСТОВ	CE	
		Контейнер с ключом для экспресс-теста на наркотические препараты	2 параметры	Контейнер	D000-1027-B1	25 ТЕСТОВ	CE
			3 параметры	Контейнер	D000-1037-B1	25 ТЕСТОВ	CE
			4 параметры	Контейнер	D000-1047-B1	25 ТЕСТОВ	CE
			5 параметры	Контейнер	D000-1057-B1	25 ТЕСТОВ	CE
6 параметры	Контейнер		D000-1067-B1	25 ТЕСТОВ	CE		
7 параметры	Контейнер		D000-1077-B1	25 ТЕСТОВ	CE		
8 параметры	Контейнер		D000-1087-B1	25 ТЕСТОВ	CE		
9 параметры	Контейнер		D000-1097-B1	25 ТЕСТОВ	CE		
10 параметры	Контейнер		D000-1107-B1	25 ТЕСТОВ	CE		

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

Экспресс-тесты на наркотические препараты

Название продукта	Формат образца	Препараты	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Контейнер с ключом для экспресс-теста на наркотические препараты		11 параметры	Контейнер	D000-1117-B1	25 ТЕСТОВ	CE
		12 параметры	Контейнер	D000-1127-B1	25 ТЕСТОВ	CE
		2 параметры	Контейнер	D000-1027-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		3 параметры	Контейнер	D000-1037-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		4 параметры	Контейнер	D000-1047-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		5 параметры	Контейнер	D000-1057-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		6 параметры	Контейнер	D000-1067-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		7 параметры	Контейнер	D000-1077-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		8 параметры	Контейнер	D000-1087-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		9 параметры	Контейнер	D000-1097-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		10 параметры	Контейнер	D000-1107-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		11 параметры	Контейнер	D000-1117-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		12 параметры	Контейнер	D000-1127-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		13 параметры	Контейнер	D000-1137-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		14 параметры	Контейнер	D000-1147-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		15 параметры	Контейнер	D000-1157-B2	25 ТЕСТОВ	CE
Контейнер с ключом для экспресс-теста на наркотические препараты (примечание: с обнаружением примесей)	Моча	16 параметров	Контейнер	D000-1167-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		2 параметры	Контейнер	DU00-1027-B1	25 ТЕСТОВ	CE
		3 параметры	Контейнер	DU00-1037-B1	25 ТЕСТОВ	CE
		4 параметры	Контейнер	DU00-1047-B1	25 ТЕСТОВ	CE
		5 параметров	Контейнер	DU00-1057-B1	25 ТЕСТОВ	CE
		6 параметров	Контейнер	DU00-1067-B1	25 ТЕСТОВ	CE
		7 параметров	Контейнер	DU00-1077-B1	25 ТЕСТОВ	CE
		8 параметров	Контейнер	DU00-1087-B1	25 ТЕСТОВ	CE
		9 параметров	Контейнер	DU00-1097-B1	25 ТЕСТОВ	CE
		10 параметров	Контейнер	DU00-1107-B1	25 ТЕСТОВ	CE
		11 параметров	Контейнер	DU00-1117-B1	25 ТЕСТОВ	CE
		12 параметров	Контейнер	DU00-1127-B1	25 ТЕСТОВ	CE
		2 параметры	Контейнер	DU00-1027-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		3 параметры	Контейнер	DU00-1037-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		4 параметры	Контейнер	DU00-1047-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		5 параметров	Контейнер	DU00-1057-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		6 параметров	Контейнер	DU00-1067-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		7 параметров	Контейнер	DU00-1077-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		8 параметров	Контейнер	DU00-1087-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		9 параметров	Контейнер	DU00-1097-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		10 параметров	Контейнер	DU00-1107-B2	25 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °С Срок годности: 24 месяца

Экспресс-тесты на наркотические препараты

Название продукта	Формат образца	Препараты	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Контейнер с ключом для экспресс-теста на наркотические препараты (примечание: с обнаружением примесей)	Моча	11 параметры	Контейнер	DU00-1117-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		12 параметры	Контейнер	DU00-1127-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		13 параметры	Контейнер	DU00-1137-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		14 параметры	Контейнер	DU00-1147-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		15 параметры	Контейнер	DU00-1157-B2	25 ТЕСТОВ	CE
		16 параметры	Контейнер	DU00-1167-B2	25 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на АВ-PINACA (ABP)	10 нг/мл	Моча	Кассета	D025-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D025-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D025-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на α-пирролидиновалерофенон (α-PVP)	300 нг/мл, 500 нг/мл, 1000 нг/мл*	Моча	Кассета	D026-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D026-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D026-1001	25/50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на катин (CAT)	150 нг/мл*	Моча	Кассета	D027-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D027-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D027-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на карисопродол (CAR)	2000 нг/мл	Моча	Кассета	D028-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D028-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D028-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на карфентанил (CFYL)	250 нг/мл, 500 нг/мл*	Моча	Кассета	D029-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D029-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D029-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на циталопрам (CIT)	500 нг/мл	Моча	Кассета	D030-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D030-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D030-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на фторкетамин (FKET)	500 нг/мл	Моча	Кассета	D031-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D031-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D031-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на флуоксетин (FLX)	1000 нг/мл	Моча	Кассета	D032-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D032-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D032-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на габапентин (GAB)	2000 нг/мл	Моча	Кассета	D033-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D033-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D033-1001	50 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

Экспресс-тесты на наркотические препараты


Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на кратом (KRA)	300 нг/мл*	Моча	Кассета	D034-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D034-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D034-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на диэтиламид лизергиновой кислоты (LSD)	10 нг/мл, 20 нг/мл*, 50 нг/мл	Моча	Кассета	D035-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D035-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D035-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на меткатинон (MCAT)	500 нг/мл	Моча	Кассета	D036-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D036-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D036-1001	25/50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на мескалин (MES)	100 нг/мл*, 300 нг/мл	Моча	Кассета	D037-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D037-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D037-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на меперидин (MPRD)	100 нг/мл	Моча	Кассета	D038-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D038-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D038-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на метаквалон (MQL)	300 нг/мл*	Моча	Кассета	D039-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D039-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D039-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на прегабалин (PGB)	50МКГ/МЛ*, 500 нг/мл	Моча	Кассета	D040-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D040-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D040-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на тилидин (TLD)	50 нг/мл*	Моча	Кассета	D041-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D041-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D041-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на трамадол (TML)	100 нг/мл*, 200 нг/мл, 300 нг/мл	Моча	Кассета	D042-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D042-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D042-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на UR-144	25 нг/мл	Моча	Кассета	D043-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D043-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D043-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на каннабинол (CNB)	500 нг/мл	Моча	Кассета	D050-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D050-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D050-1001	50 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

Экспресс-тесты на наркотические препараты

Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на рисперидон (RPD)	150 нг/мл	Моча	Кассета	D051-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D051-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D051-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на папаверин (PAP)	500 нг/мл*	Моча	Кассета	D052-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D052-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D052-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на алпразолам (ALP)	100 нг/мл*	Моча	Кассета	D053-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D053-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D053-1001	25/50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на кофеин (CAF)	1000 нг/мл*	Моча	Кассета	D054-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D054-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D054-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на клоназепам (CLO)	150 нг/мл, 400 нг/мл*	Моча	Кассета	D055-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D055-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D055-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на диазепам (DIA)	300 нг/мл*	Моча	Кассета	D047-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D047-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D047-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на гидрохлорид мефедрона (MEP)	100 нг/мл*	Моча	Кассета	D056-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D056-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D056-1001	50 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

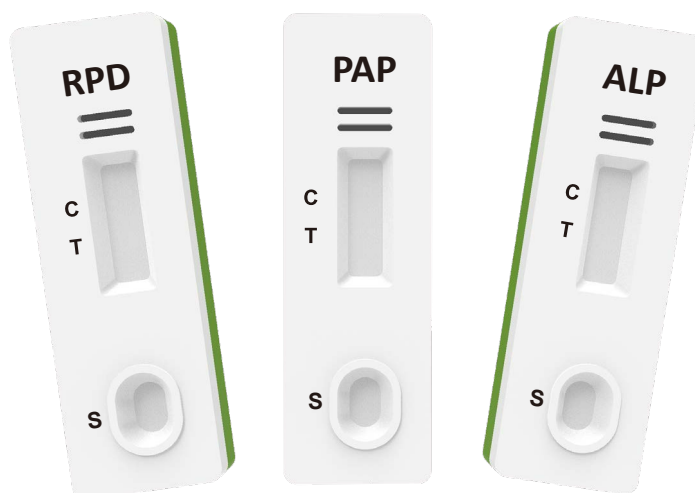

Экспресс-тесты на наркотические препараты

Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на кветиапин (QTP)	1000 нг/мл	Моча	Кассета	D057-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D057-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D057-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на тразодон (TZD)	200 нг/мл	Моча	Кассета	D058-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D058-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D058-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на залеплон (ZAL)	100 нг/мл	Моча	Кассета	D059-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D059-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D059-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на тропикамид (TRO)	350 нг/мл*	Моча	Кассета	D060-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D060-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D060-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на ацетаминофен (ACE)	5000 нг/мл*	Моча	Кассета	D046-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D046-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D046-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на 6-моноацетилморфин (6-МAM)	10 нг/мл*	Моча	Кассета	D044-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D044-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D044-1001	50 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °С Срок годности: 24 месяца



Экспресс-тесты на наркотические препараты

Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на тенамфетамин (MDA)	500 нг/мл*	Моча	Кассета	D048-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D048-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D048-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на метилendioксипировалерон (MDPV)	300 нг/мл, 500 нг/мл, 1000 нг/мл*	Моча	Кассета	D045-1002	25 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D045-1014	25 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D045-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на оланзапин (OZP)	1000 нг/мл*	Моча	Кассета	D061-1002	25/40 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D061-1014	25/40 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D061-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на пропоксифен (PPX)	300 нг/мл*	Моча	Кассета	D049-1002	25/40 ТЕСТОВ	CE
			Панель	D049-1014	25/40 ТЕСТОВ	CE
			Тестовая полоска	D049-1001	50 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на амфетамин (AMP) (по образцам ротовой жидкости)	50 нг/мл*	Ротовая жидкость	Кассета	D002-8002	25 ТЕСТОВ	CE
			Устройство	D002-8003	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на α-пирролидиновалерофенон (α-PVP) (по образцам ротовой жидкости)	300 нг/мл*	Ротовая жидкость	Кассета	D026-8002	25 ТЕСТОВ	CE
			Устройство	D026-8003	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на барбитурат (BAR) (по образцам ротовой жидкости)	50 нг/мл*	Ротовая жидкость	Кассета	D003-8002	25 ТЕСТОВ	CE
			Устройство	D003-8003	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на бупренорфин (BUP) (по образцам ротовой жидкости)	10 нг/мл*	Ротовая жидкость	Кассета	D004-8002	25 ТЕСТОВ	CE
			Устройство	D004-8003	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на бензодиазепины (BZO) (по образцам ротовой жидкости)	20 нг/мл, 30 нг/мл*, 50 нг/мл	Ротовая жидкость	Кассета	D005-8002	25 ТЕСТОВ	CE
	30 нг/мл*		Устройство	D005-8003	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на кокаин (COC) (по образцам ротовой жидкости)	20 нг/мл*	Ротовая жидкость	Кассета	D006-8002	25 ТЕСТОВ	CE
			Устройство	D006-8003	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на карфентанил (CFYL) (по образцам ротовой жидкости)	50 нг/мл*	Ротовая жидкость	Кассета	D029-8002	25 ТЕСТОВ	CE
			Устройство	D029-8003	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на котинин (COT) (по образцам ротовой жидкости)	20 нг/мл*	Ротовая жидкость	Кассета	D007-8002	25 ТЕСТОВ	CE
			Устройство	D007-8003	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на фентанил (FYL) (по образцам ротовой жидкости)	20 нг/мл, 50 нг/мл*	Ротовая жидкость	Кассета	D010-8002	25 ТЕСТОВ	CE
			Устройство	D010-8003	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на кетамин (KET) (по образцам ротовой жидкости)	50 нг/мл*	Ротовая жидкость	Кассета	D011-8002	25 ТЕСТОВ	CE
			Устройство	D011-8003	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на 6-моноацетилморфин (6-MAM) (по образцам ротовой жидкости)	10 нг/мл*	Ротовая жидкость	Кассета	D044-8002	25 ТЕСТОВ	CE
			Устройство	D044-8003	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на экстази (MDMA) (по образцам ротовой жидкости)	50 нг/мл*	Ротовая жидкость	Кассета	D012-8002	25 ТЕСТОВ	CE
			Устройство	D012-8003	25 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

Экспресс-тесты на наркотические препараты

Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на метилendioксипировалерон (MDPV) (по образцам ротовой жидкости)	300 нг/мл*	Ротовая жидкость	Кассета	D045-8002	25 ТЕСТОВ	CE
			Устройство	D045-8003	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на метамфетамин (MET)(по образцам ротовой жидкости)	50 нг/мл*	Ротовая жидкость	Кассета	D013-8002	25 ТЕСТОВ	CE
			Устройство	D013-8003	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на метадон (MTD) (по образцам ротовой жидкости)	30 нг/мл*	Ротовая жидкость	Кассета	D016-8002	25 ТЕСТОВ	CE
			Устройство	D016-8003	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на опиаты (OPI) (по образцам ротовой жидкости)	40 нг/мл*	Ротовая жидкость	Кассета	D017-8002	25 ТЕСТОВ	CE
			Устройство	D017-8003	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на оксикодон (ОХУ) (по образцам ротовой жидкости)	20 нг/мл*	Ротовая жидкость	Кассета	D018-8002	25 ТЕСТОВ	CE
			Устройство	D018-8003	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на фенциклидин (PCP)(по образцам ротовой жидкости)	10 нг/мл*	Ротовая жидкость	Кассета	D019-8002	25 ТЕСТОВ	CE
			Устройство	D019-8003	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на синтетические каннабиноиды(K2) (по образцам ротовой жидкости)	25 нг/мл*	Ротовая жидкость	Кассета	D020-8002	25 ТЕСТОВ	CE
			Устройство	D020-8003	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на марихуану (THC) (по образцам ротовой жидкости)	20 нг/мл*, 50 нг/мл	Ротовая жидкость	Кассета	D022-P8002	25 ТЕСТОВ	CE
	50 нг/мл*		Устройство	D022-8003	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на трамадол (TML) (по образцам ротовой жидкости)	30 нг/мл*	Ротовая жидкость	Кассета	D042-8002	25 ТЕСТОВ	CE
			Устройство	D042-8003	25 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

Название продукта	Формат образца	Препараты	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на наркотические препараты (по образцам ротовой жидкости)	Ротовая жидкость	2 параметры	Устройство	D000-8023-A	25 ТЕСТОВ	CE
		3 параметры	Устройство	D000-8033-A	25 ТЕСТОВ	CE
		4 параметры	Устройство	D000-8043-A	25 ТЕСТОВ	CE
		5 параметров	Устройство	D000-8053-A	25 ТЕСТОВ	CE
		6 параметров	Устройство	D000-8063-A	25 ТЕСТОВ	CE
		7 параметров	Устройство	D000-8073-A	25 ТЕСТОВ	CE
		2 параметры	Устройство	D000-8023-B	25 ТЕСТОВ	CE
		3 параметры	Устройство	D000-8033-B	25 ТЕСТОВ	CE
		4 параметры	Устройство	D000-8043-B	25 ТЕСТОВ	CE
		5 параметров	Устройство	D000-8053-B	25 ТЕСТОВ	CE
		6 параметров	Устройство	D000-8063-B	25 ТЕСТОВ	CE
		7 параметров	Устройство	D000-8073-B	25 ТЕСТОВ	CE
		8 параметров	Устройство	D000-8083-B	25 ТЕСТОВ	CE
		9 параметров	Устройство	D000-8093-B	25 ТЕСТОВ	CE
		2 параметры	Устройство	D000-8023-D	25 ТЕСТОВ	CE
		3 параметры	Устройство	D000-8033-D	25 ТЕСТОВ	CE
		4 параметры	Устройство	D000-8043-D	25 ТЕСТОВ	CE
		5 параметров	Устройство	D000-8053-D	25 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

Экспресс-тесты на наркотические препараты

Название продукта	Формат образца	Препараты	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на наркотические препараты (по образцам ротовой жидкости)	Ротовая жидкость	6 параметры	Устройство	D000-8063-D	25 ТЕСТОВ	CE
		7 параметры	Устройство	D000-8073-D	25 ТЕСТОВ	CE
		8 параметры	Устройство	D000-8083-D	25 ТЕСТОВ	CE
		9 параметры	Устройство	D000-8093-D	25 ТЕСТОВ	CE
		10 параметры	Устройство	D000-8103-D	25 ТЕСТОВ	CE
		11 параметры	Устройство	D000-8113-D	25 ТЕСТОВ	CE
		12 параметры	Устройство	D000-8123-D	25 ТЕСТОВ	CE
Кассета для экспресс-теста на наркотические препараты (по образцам ротовой жидкости)	Ротовая жидкость	2 параметры	Кассета	D000-8025-A	25 ТЕСТОВ	CE
		3 параметры	Кассета	D000-8035-A	25 ТЕСТОВ	CE
		4 параметры	Кассета	D000-8045-A	25 ТЕСТОВ	CE
		5 параметров	Кассета	D000-8055-A	25 ТЕСТОВ	CE
		6 параметров	Кассета	D000-8065-A	25 ТЕСТОВ	CE
		7 параметров	Кассета	D000-8075-A	25 ТЕСТОВ	CE
		8 параметров	Кассета	D000-8085-A	25 ТЕСТОВ	CE
		9 параметров	Кассета	D000-8095-A	25 ТЕСТОВ	CE
		2 параметры	Кассета	D000-8025-B	25 ТЕСТОВ	CE
		3 параметров	Кассета	D000-8035-B	25 ТЕСТОВ	CE
		4 параметров	Кассета	D000-8045-B	25 ТЕСТОВ	CE
		5 параметров	Кассета	D000-8055-B	25 ТЕСТОВ	CE
		6 параметров	Кассета	D000-8065-B	25 ТЕСТОВ	CE
		7 параметров	Кассета	D000-8075-B	25 ТЕСТОВ	CE
		8 параметров	Кассета	D000-8085-B	25 ТЕСТОВ	CE
		2 параметры	Контейнер	D000-8027	20 ТЕСТОВ	CE
Контейнер для экспресс-теста на наркотические препараты (по образцам ротовой жидкости)	Ротовая жидкость	3 параметров	Контейнер	D000-8037	20 ТЕСТОВ	CE
		4 параметров	Контейнер	D000-8047	20 ТЕСТОВ	CE
		5 параметров	Контейнер	D000-8057	20 ТЕСТОВ	CE
		6 параметров	Контейнер	D000-8067	20 ТЕСТОВ	CE
		7 параметров	Контейнер	D000-8077	20 ТЕСТОВ	CE
		8 параметров	Контейнер	D000-8087	20 ТЕСТОВ	CE
		9 параметров	Контейнер	D000-8097	20 ТЕСТОВ	CE
		10 параметров	Контейнер	D000-8107	20 ТЕСТОВ	CE
		11 параметров	Контейнер	D000-8117	20 ТЕСТОВ	CE
		12 параметров	Контейнер	D000-8127	20 ТЕСТОВ	CE
		2 параметры	Контейнер	D000-8027-C	20 ТЕСТОВ	CE
		3 параметров	Контейнер	D000-8037-C	20 ТЕСТОВ	CE
		4 параметров	Контейнер	D000-8047-C	20 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

Экспресс-тесты на наркотические препараты

Название продукта

Контейнер для экспресс-теста на наркотические препараты (по образцам ротовой жидкости)

Формат образца	Препараты	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Ротовая жидкость	5 параметры	Контейнер	D000-8057-C	20 ТЕСТОВ	CE
	6 параметры	Контейнер	D000-8067-C	20 ТЕСТОВ	CE
	7 параметры	Контейнер	D000-8077-C	20 ТЕСТОВ	CE
	8 параметры	Контейнер	D000-8087-C	20 ТЕСТОВ	CE
	9 параметры	Контейнер	D000-8097-C	20 ТЕСТОВ	CE
	10 параметры	Контейнер	D000-8107-C	20 ТЕСТОВ	CE
	11 параметры	Контейнер	D000-8117-C	20 ТЕСТОВ	CE
	12 параметры	Контейнер	D000-8127-C	20 ТЕСТОВ	CE
	13 параметры	Контейнер	D000-8137-C	20 ТЕСТОВ	CE
	14 параметры	Контейнер	D000-8147-C	20 ТЕСТОВ	CE
	15 параметров	Контейнер	D000-8157-C	20 ТЕСТОВ	CE
	16 параметров	Контейнер	D000-8167-C	20 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца



Экспресс-тесты на наркотические препараты

Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на ацетаминифен (ACE) (по образцам порошка)	5000 нг/мл	Порошок	Панель	D046-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на амфетамин (AMP) (по образцам порошка)	1000 нг/мл	Порошок	Панель	D002-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на α-пирролидиновалерофенон (α-PVP) (по образцам порошка)	1000 нг/мл	Порошок	Панель	D026-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на барбитурат (BAR) (по образцам порошка)	300 нг/мл	Порошок	Панель	D003-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на бупренорфин (BUP) (по образцам порошка)	10 нг/мл	Порошок	Панель	D004-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на бензодиазепины (BZO) (по образцам порошка)	300 нг/мл	Порошок	Панель	D005-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на кокаин (COC) (по образцам порошка)	300 нг/мл	Порошок	Панель	D006-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на карфентанил (CFYL) (по образцам порошка)	500 нг/мл	Порошок	Панель	D029-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на котинин (COT) (по образцам порошка)	200 нг/мл	Порошок	Панель	D007-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на диазепам (DIA) (по образцам порошка)	300 нг/мл	Порошок	Панель	D047-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на фентанил (FYL) (по образцам порошка)	200 нг/мл	Порошок	Панель	D010-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на кетамин (KET) (по образцам порошка)	1000 нг/мл	Порошок	Панель	D011-X014	25 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °С Срок годности: 24 месяца



Экспресс-тесты на наркотические препараты

Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на диэтиламид лизергиновой кислоты (LSD) (по образцам порошка)	20 нг/мл	Порошок	Панель	D035-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на экстази (MDMA) (по образцам порошка)	500 нг/мл	Порошок	Панель	D012-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на тенамфетамин (MDA) (по образцам порошка)	500 нг/мл	Порошок	Панель	D048-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на метилendioксипировалерон (MDPV) (по образцам порошка)	1000 нг/мл	Порошок	Панель	D045-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на метилфенидат (MPD) (по образцам порошка)	300 нг/мл	Порошок	Панель	D015-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на метамфетамин (MET) (по образцам порошка)	1000 нг/мл	Порошок	Панель	D013-X014	25/40 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на морфин (MOP) (по образцам порошка)	300 нг/мл	Порошок	Панель	D014-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на метаквалон (MQL) (по образцам порошка)	300 нг/мл	Порошок	Панель	D039-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на метадон (MTD) (по образцам порошка)	300 нг/мл	Порошок	Панель	D016-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на оксикодон (OXY) (по образцам порошка)	100 нг/мл	Порошок	Панель	D018-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на опиаты (OPI) (по образцам порошка)	2000 нг/мл	Порошок	Панель	D017-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на фенциклидин (PCP) (по образцам порошка)	25 нг/мл	Порошок	Панель	D019-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на пропоксифен (PPX) (по образцам порошка)	300 нг/мл	Порошок	Панель	D049-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на синтетические каннабиноиды (K2) (по образцам порошка)	50 нг/мл	Порошок	Панель	D020-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на трициклические антидепрессанты (ТЦА) (по образцам порошка)	1000 нг/мл	Порошок	Панель	D021-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на марихуану (THC) (по образцам порошка)	50 нг/мл	Порошок	Панель	D022-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на трамадол (TML) (по образцам порошка)	100 нг/мл	Порошок	Панель	D042-X014	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на золпидем (ZOL) (по образцам порошка)	50 нг/мл	Порошок	Панель	D023-X014	25 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

Экспресс-тесты на наркотические препараты

Название продукта	Формат образца	Препараты	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на наркотические препараты (по образцам порошка)	Порошок	2 параметры	Панель	D000-X024	25 ТЕСТОВ	CE
		3 параметры	Панель	D000-X034	25 ТЕСТОВ	CE
		4 параметры	Панель	D000-X044	25 ТЕСТОВ	CE
		5 параметров	Панель	D000-X054	25 ТЕСТОВ	CE
		6 параметров	Панель	D000-X064	25 ТЕСТОВ	CE
		7 параметров	Панель	D000-X074	25 ТЕСТОВ	CE
		8 параметров	Панель	D000-X084	25 ТЕСТОВ	CE
		9 параметров	Панель	D000-X094	25 ТЕСТОВ	CE
		10 параметров	Панель	D000-X104	25 ТЕСТОВ	CE
		11 параметров	Панель	D000-X114	25 ТЕСТОВ	CE
		12 параметров	Панель	D000-X124	25 ТЕСТОВ	CE
		13 параметров	Панель	D000-X134	25 ТЕСТОВ	CE
		14 параметров	Панель	D000-X144	25 ТЕСТОВ	CE
		15 параметров	Панель	D000-X154	25 ТЕСТОВ	CE
		16 параметров	Панель	D000-X164	25 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на AMP (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	80 нг/мл	Цельная кровь/Сыворотка/плазма	Кассета	D002-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на BAR (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	100 нг/мл	Цельная кровь/Сыворотка/плазма	Кассета	D003-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на BUP (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	5 нг/мл	Цельная кровь/Сыворотка/плазма	Кассета	D004-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на BZO (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	100 нг/мл	Цельная кровь/Сыворотка/плазма	Кассета	D005-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на СОС (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	50 нг/мл	Цельная кровь/Сыворотка/плазма	Кассета	D006-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на СОТ (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	10 нг/мл, 100 нг/мл*	Цельная кровь/Сыворотка/плазма	Кассета	D007-4002	25 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

Экспресс-тесты на наркотические препараты

Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на EDDP (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	50 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	D008-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на FYL (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	15 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	D010-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на KET (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	200 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	D011-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на LSD (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	20 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	D035-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на MDMA (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	50 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	D012-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на MDA (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	80 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	D048-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на MDPV (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	500 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	D045-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на MET (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	70 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	D013-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на MOR (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	40 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	D014-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на MTD (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	40 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	D016-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на OXY (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	20 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	D018-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на PCP (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	20 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	D019-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на PPX (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	100 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	D049-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на K2 (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	100 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	D020-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на ТЦА (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	300 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	D021-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на ТНС (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	35 нг/мл*, 50 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	D022-4002	10/25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на TML (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	50 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	D042-4002	25 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °С Срок годности: 24 месяца

Экспресс-тесты на наркотические препараты

Название продукта	Формат образца	Препараты	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на наркотические препараты (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	2 параметра	Кассета	D000-4025	10/25 ТЕСТОВ	CE
		3 параметра	Кассета	D000-4035	10/25 ТЕСТОВ	CE
		4 параметра	Кассета	D000-4045	10/25 ТЕСТОВ	CE
		5 параметра	Кассета	D000-4055	10/25 ТЕСТОВ	CE
		6 параметра	Кассета	D000-4065	10/25 ТЕСТОВ	CE
		7 параметра	Кассета	D000-4075	10/25 ТЕСТОВ	CE
		8 параметра	Кассета	D000-4085	10/25 ТЕСТОВ	CE
		9 параметра	Кассета	D000-4095	10/25 ТЕСТОВ	CE
		10 параметра	Кассета	D000-4105	10/25 ТЕСТОВ	CE
		11 параметра	Кассета	D000-4115	10/25 ТЕСТОВ	CE
		12 параметра	Кассета	D000-4125	10/25 ТЕСТОВ	CE
		13 параметра	Кассета	D000-4135	10/25 ТЕСТОВ	CE
		14 параметра	Кассета	D000-4145	10/25 ТЕСТОВ	CE
		15 параметра	Кассета	D000-4155	10/25 ТЕСТОВ	CE
		16 параметра	Кассета	D000-4165	10/25 ТЕСТОВ	CE
		17 параметра	Кассета	D000-4175	10/25 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца



Экспресс-тесты на наркотические препараты

Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на амфетамин (AMP) (по образцам волос)	0.2 нг/мг	Волосы	Кассета	D002-H9002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на барбитурат (BAR) (по образцам волос)	0.2 нг/мг	Волосы	Кассета	D003-H9002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на бупренорфин (BUP) (по образцам волос)	0.2 нг/мг	Волосы	Кассета	D004-H9002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на бензодиазепины (BZO) (по образцам волос)	0.2 нг/мг	Волосы	Кассета	D005-H9002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на кокаин (COC) (по образцам волос)	0.5 нг/мг	Волосы	Кассета	D006-H9002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на котинин (COT) (по образцам волос)	0.2 нг/мг	Волосы	Кассета	D007-H9002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на кетамин (KET) (по образцам волос)	0.2 нг/мг	Волосы	Кассета	D011-H9002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на 6-моноацетилморфин (6-MAM) (по образцам волос)	0.2 нг/мг	Волосы	Кассета	D044-H9002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на экстази (MDMA) (по образцам волос)	0.2 нг/мг	Волосы	Кассета	D012-H9002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на метамфетамин (MET) (по образцам волос)	0.2 нг/мг	Волосы	Кассета	D013-H9002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на морфин (MOR) (по образцам волос)	0.2 нг/мг	Волосы	Кассета	D014-H9002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на оксикодон (OXY) (по образцам волос)	0.2 нг/мг	Волосы	Кассета	D018-H9002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на фенциклидин (PCP) (по образцам волос)	0.2 нг/мг	Волосы	Кассета	D019-H9002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на синтетические каннабиноиды (K2) (по образцам волос)	0.2 нг/мг	Волосы	Кассета	D020-H9002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на АВ-PINACA (ABP) (по образцам волос)	0.2 нг/мг	Волосы	Кассета	D025-H9002	10 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца

Экспресс-тесты на наркотические препараты

Название продукта

Экспресс-тест на наркотические препараты (по образцам волос)

Формат образца	Препараты	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Волосы	2 параметра	Кассета	D000-H9025	10 ТЕСТОВ	CE
	3 параметра	Кассета	D000-H9035	10 ТЕСТОВ	CE
	4 параметра	Кассета	D000-H9045	10 ТЕСТОВ	CE
	5 параметра	Кассета	D000-H9055	10 ТЕСТОВ	CE
	6 параметра	Кассета	D000-H9065	10 ТЕСТОВ	CE
	7 параметра	Кассета	D000-H9075	10 ТЕСТОВ	CE
	8 параметра	Кассета	D000-H9085	10 ТЕСТОВ	CE
	9 параметра	Кассета	D000-H9095	10 ТЕСТОВ	CE
	10 параметра	Кассета	D000-H9105	10 ТЕСТОВ	CE
	11 параметра	Кассета	D000-H9115	10 ТЕСТОВ	CE
	12 параметра	Кассета	D000-H9125	10 ТЕСТОВ	CE
	13 параметра	Кассета	D000-H9135	10 ТЕСТОВ	CE


*Температура хранения: 2–30 °C Срок годности: 24 месяца



Экспресс-тесты на онкомаркеры

Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на АФП	10 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	T001-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на РЭА	5 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	T002-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на СА 125	40 U/mL	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	T003-4002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на СА 15-3	30 U/mL	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	T004-4002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на СА 19-9	40 U/mL	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	T005-4002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на скрытую фекальную кровь	25 нг/мл, 40 нг/мл, 50 нг/мл*, 100 нг/мл	Кал	Кассета	T006-6002	25 ТЕСТОВ	CE
	40 нг/мл, 50 нг/мл*	Кал	Тестовая полоска	T006-6001	25 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на кальпротектин и скрытую фекальную кровь	См. листок-вкладыш	Кал	Кассета	T007-6025	10 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на трансферрин и скрытую фекальную кровь	См. листок-вкладыш	Кал	Кассета	T008-6025	25 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на Hb и Hb-Hp	50 нг/мл	Кал	Кассета	T009-6025	25 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на трансферрин/скрытую фекальную кровь и комплекс Hb-Hp	См. листок-вкладыш	Кал	Кассета	I087-6035	10/20/25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест для качественного определения ПСА	4 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	T011-Q4002	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на ПСА	3-10 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	T010-4002	25 ТЕСТОВ	NON-CE


*Температура хранения: 2-30 °C Срок годности: 24 месяца

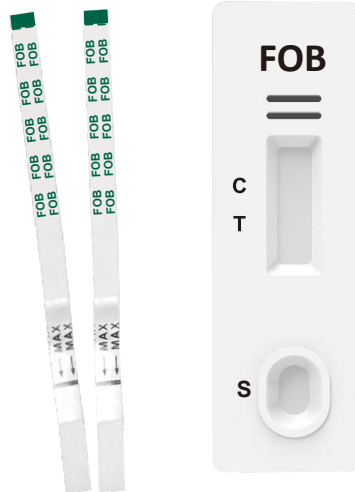

Экспресс-тесты на кардиомаркеры

Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на сердечный тропонин I (cTnI)	0.5 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	C001-4002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на сердечный тропонин T (cTnT)	0.5 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	C002-4002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на СК-МВ	5 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	C003-4002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на миоглобин	50 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	C004-4002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на H-FABP	8 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	C005-4002	10 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на H-FABP и cTnI	См. листок-вкладыш	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	C006-4025	25 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на миоглобин/СК-МВ/тропонин I	См. листок-вкладыш	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	C007-4035	10 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на H-FABP и миоглобин/СК-МВ/сердечный тропонин I	См. листок-вкладыш	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	C007-4045	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на NT-proBNP	0.45 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	C008-4002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на D-димер	500 нг/мл*	Цельная кровь /плазма	Кассета	C009-4002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на С-реактивный белок	10МКГ/МЛ	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Тестовая полоска	C010-4001	10 ТЕСТОВ	CE
	10МКГ/МЛ*		Кассета	C010-4002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест для полуколичественного определения С-реактивного белка	10-40-80МКГ/МЛ	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Тестовая полоска	C010-U4001	10 ТЕСТОВ	CE
	10-40-80МКГ/МЛ		Кассета	C010-U4002	10 ТЕСТОВ	CE
	10-30МКГ/МЛ		Кассета	C010-T4002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на прокальцитонин (ПКТ) (по образцам сыворотки/плазмы)	1 нг/мл	Сыворотка/плазма	Кассета	C011-3002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на прокальцитонин (ПКТ) (по образцам цельной крови/сыворотки/плазмы)	1 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	C011-4002	10 ТЕСТОВ	CE

*Температура хранения: 2-30 °C Срок годности: 24 месяца

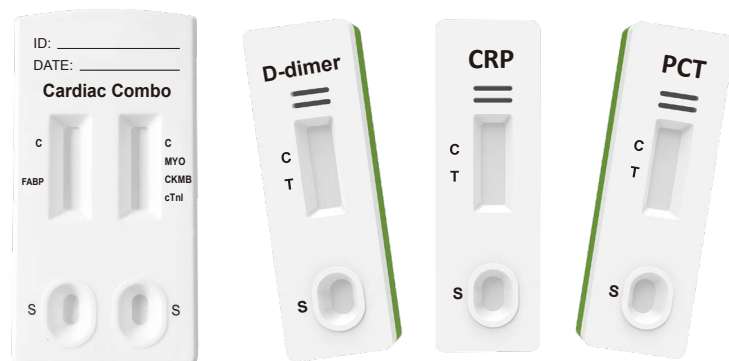

Другие экспресс-тесты

Название продукта	порог обнаружения	Формат образца	Образца	Категория	Количество тестов в наборе	Сертификация CE
Экспресс-тест на ферритин	30 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	O001-4002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест для полуколичественного определения ферритина	13-30 нг/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	O001-T4002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на белок SP-10 для определения мужской фертильности	15 миллионов/мл	Сперма	Кассета	O002-9002	1/2 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на ТТГ	5 мкМЕ/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	O003-4002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на витамин D	10-30-100 нг/мл	Цельная кровь	Кассета	O004-4002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на HbA1c	6%-9%	Цельная кровь	Кассета	O005-4002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест для обнаружения крови по пятну	50 нг/мл	Пятно	Кассета	O006-9002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест для обнаружения семенной жидкости человека	4 нг/мл	Пятно	Тестовая полоска	O007-9001	50 ТЕСТОВ	CE
	4 нг/мл		Кассета	O007-9002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на кальпротектин	50 мкг/г	Кал	Кассета	O008-6002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на лактоферрин	100 нг/мл	Кал	Кассета	O009-6002	10 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на кальпротектин и лактоферрин	/	Кал	Кассета	O010-6025	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на IgE	200 МЕ/мл	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	O011-4002	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на ревматоидный фактор	25 МЕ/мл	Сыворотка/плазма	Кассета	O012-3002	20 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест для полуколичественного определения микроальбумина	20-40-60-80МКГ/МЛ	Моча	Тестовая полоска	O013-1001	50 ТЕСТОВ	CE
			Кассета	O013-1002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест для качественного определения микроальбумина	20МКГ/МЛ	Моча	Тестовая полоска	O014-1001	50 ТЕСТОВ	CE
			Кассета	O014-1002	25 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на SAA	10МКГ/МЛ	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	O015-4002	10 ТЕСТОВ	CE
Комбинированный экспресс-тест на SAA и СРБ	10МКГ/МЛ	Цельная кровь/ Сыворотка/плазма	Кассета	O016-4025	10 ТЕСТОВ	CE
Экспресс-тест на определение группы крови по системе ABO	/	Цельная кровь	Кассета	O019-4002	25 ТЕСТОВ	NON-CE
Экспресс-тест на определение группы крови по системе ABO и резус-фактора	/	Цельная кровь	Кассета	O020-4002	25 ТЕСТОВ	NON-CE

*Температура хранения: 2-30 °C Срок годности: 24 месяца



Hangzhou Tongzhou Biotechnology Co., Ltd.

Room 102, Building 4, No. 191, Xintian Road, Yunhe Street,
Linping District, Hangzhou, China.

Email: Tongzhou01@tongzhoubio.com. / service@tongzhoubio.com.